

Phonak Audéo™ B-Direct

(B90/B70/B50)

Instrucciones de uso



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Estas instrucciones de uso son válidas para:

Modelos inalámbricos	Marcado CE
Phonak Audéo B90-Direct	2017
Phonak Audéo B70-Direct	2017
Phonak Audéo B50-Direct	2017



Información sobre su audífono

i Sus audífonos funcionan en un rango de frecuencia de 2,4 GHz a 2,48 GHz. Al realizar un vuelo, consulte al operador si necesita que los dispositivos se pongan en modo avión. Consulte el capítulo 10.

Modelo

Audéo B-Direct (B90, B70, B50)

Tamaño de la pila

13

Auricular

- Cápsula
- SlimTip
- cShell

Su audioprotesista:

┌

└

┌

└

Sus audífonos han sido desarrollados por Phonak, el líder mundial en soluciones auditivas asentado en Zúrich, Suiza.

Estos productos de nivel superior son el resultado de décadas de investigación y experiencia, y están diseñados para que reviva la belleza del sonido. Le agradecemos su elección y le deseamos que disfrute de una gran audición durante muchos años.

Lea las instrucciones de uso atentamente para asegurarse de que entiende sus audífonos y les saca el máximo partido. Para obtener más información acerca de las funciones y ventajas, simplemente póngase en contacto con su audioprotesista.

Phonak – life is on
www.phonak.es

Contenido

El audífono

- 1. Guía rápida 6
- 2. Descripción del audífono 8

Uso del audífono


- 3. Marcas de audífonos izquierdo y derecho 9
- 4. Encendido/apagado 10
- 5. Pilas 11
- 6. Colocación del audífono 13
- 7. Retirada del audífono 14
- 8. Botón pulsador 15
- 9. Llamadas telefónicas 16
- 10. Modo avión 23

Información adicional

- 11. Cuidado y mantenimiento 25
- 12. Sustitución del sistema anticerumen 28
- 13. Descripción general de la conectividad 33
- 14. Servicio y garantía 34
- 15. Información de cumplimiento normativo 36
- 16. Información y explicación de los símbolos 41
- 17. Solución de problemas 46
- 18. Información de seguridad importante 48

1. Guía rápida

Marcas de audífonos izquierdo y derecho




Marca azul para el **audífono izquierdo**.
Marca roja para el **audífono derecho**.

Cambio de pilas



1 Retire el plástico protector de la pila nueva y espere dos minutos.




2 Abra la tapa del portapilas.




3 Coloque la pila en el portapilas con el símbolo "+" hacia arriba.

Encendido/apagado




Encendido



Apagado

Botón pulsador



El botón pulsador tiene dos funciones principales:

1. El botón pulsador de su audífono puede cambiar el volumen o los programas en función de la programación del audífono. Esto se indica en sus instrucciones individuales.
2. Si el audífono se empareja con un teléfono, con una pulsación corta (menos de dos segundos) aceptará una llamada entrante y con una pulsación larga (más de dos segundos) la rechazará.

Modo avión




Para activar el modo avión, mantenga apretado el botón pulsador durante 10 segundos a la vez que cierra la tapa del portapilas. Para desactivar el modo avión, simplemente abra y cierre la tapa del portapilas de nuevo.

2. Descripción del audífono

En la siguiente imagen se muestra el modelo que se describe en estas instrucciones de uso.


Posibles auriculares



Cápsula




SlimTip



cShell

Audéo B-Direct

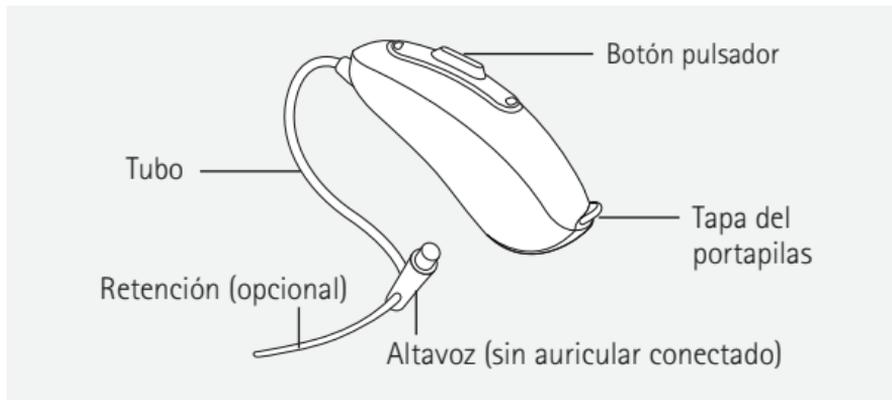

3. Marcas de audífonos izquierdo y derecho

Hay una marca roja o azul dentro de la tapa del portapilas y en el altavoz. Esta marca le indicará si es un audífono izquierdo o derecho.



Marca azul para el **audífono izquierdo**.


Marca roja para el **audífono derecho**.

4. Encendido/apagado

La tapa del portapilas también es el interruptor de encendido/apagado.


1

Tapa del portapilas cerrada =
audífono **encendido**

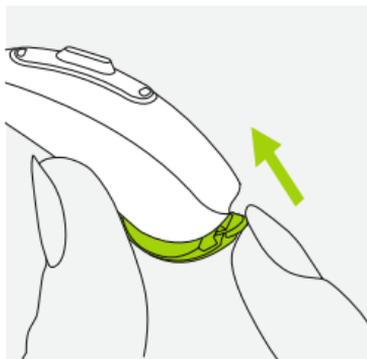


2

Tapa del portapilas abierta =
audífono **apagado**

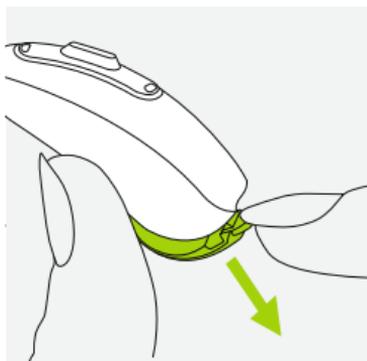


❶ Cuando encienda el audífono puede que escuche una melodía de inicio.

5. Pilas




1

Retire el plástico protector de la pila nueva y espere dos minutos.



2

Abra la tapa del portapilas.



3

Coloque la pila en el portapilas con el símbolo "+" hacia arriba.

- ❗ Si le resulta difícil cerrar la tapa del portapilas: Compruebe que la pila esté insertada correctamente y que el símbolo "+" esté orientado hacia la marca "+" del interior del portapilas. Si la pila no se introduce de la forma correcta, el audífono no funcionará y la tapa del portapilas podría dañarse.

 Batería baja: oirá dos pitidos cuando el nivel de la pila sea bajo. Dispondrá de unos 30 minutos para cambiar la pila (esto puede variar en función de los ajustes del audífono y de la pila). Se recomienda que tenga siempre a mano una pila nueva.

Pila de repuesto

Este audífono necesita una pila de zinc-aire tamaño 13.

Modelo	Tamaño de pila de zinc-aire	Marca de color en el paquete	Código IEC	Código ANSI
Phonak Audéo				
B-Direct	13	naranja	PR48	7000ZD

 Asegúrese de utilizar el tipo de pila correcto en los audífonos (zinc-aire). Lea también el capítulo 18.2 para obtener más información sobre la seguridad del producto.

6. Colocación del audífono


1

Colóquese el audífono detrás de la oreja.




2

Inserte el auricular en el conducto auditivo.

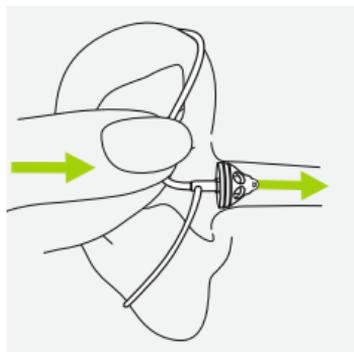

3


Si hay una retención conectada al auricular, introdúzcala en la cavidad de la oreja para fijar el audífono.

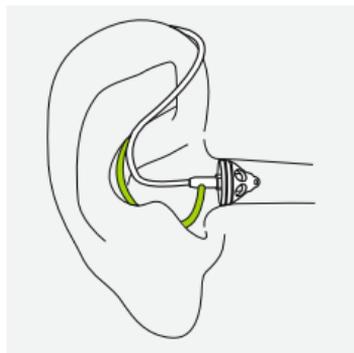

7. Retirada del audífono

1

Tire suavemente de la curva del tubo y retire el audífono de detrás de la oreja.

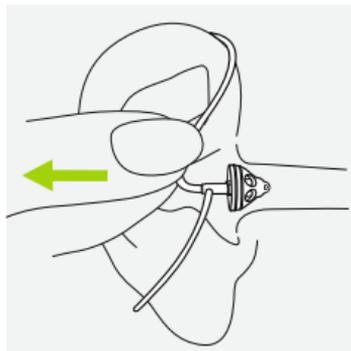


⚠ En contadas ocasiones, la cápsula puede quedarse en el conducto auditivo al extraer el tubo del oído. En el caso improbable de que la cápsula se quede en el conducto auditivo, se recomienda encarecidamente que se ponga en contacto con un médico para que efectúe una extracción segura.

8. Botón pulsador

El botón pulsador tiene dos funciones principales:


1. El botón pulsador de su audífono puede cambiar volumen o programas en función de la programación del audífono. Esto se indica en sus instrucciones individuales.

2. Si el audífono se empareja con un teléfono, con una pulsación corta (menos de dos segundos) aceptará una llamada entrante y con una pulsación larga (más de dos segundos) la rechazará. Consulte el capítulo 9 para obtener más información sobre el uso del teléfono.

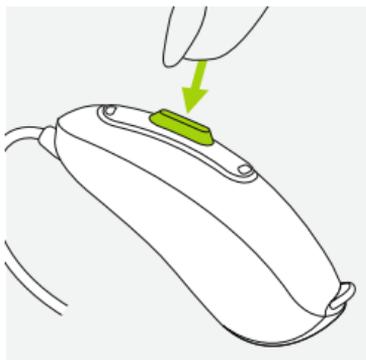

9. Llamadas telefónicas

Su audífono admite comunicación directa con teléfonos compatibles con Bluetooth®. Cuando lo empareja y conecta con un teléfono, oirá la voz de la persona que llama directamente en su audífono. Su audífono recogerá su voz a través de sus propios micrófonos.

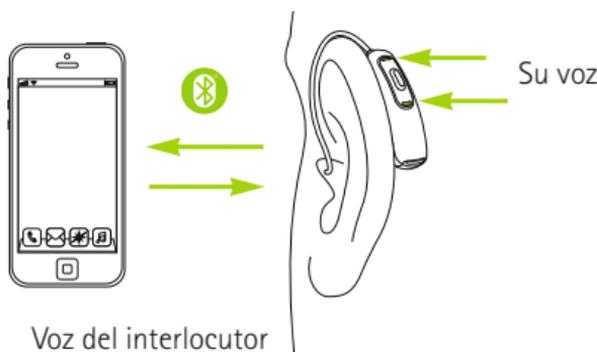

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

9.1 Emparejamiento inicial con un teléfono


- ① Solo es necesario realizar el procedimiento de emparejamiento una vez con cada teléfono con tecnología inalámbrica Bluetooth. Después del emparejamiento inicial, su audífono se conectará automáticamente al teléfono. Esto puede durar hasta dos minutos.

1

Compruebe que la tecnología inalámbrica Bluetooth esté activada en su teléfono y busque dispositivos compatibles con Bluetooth en el menú de ajustes de conectividad.

2

Encienda sus audífonos. Ahora dispone de tres minutos para emparejar sus audífonos con su teléfono.

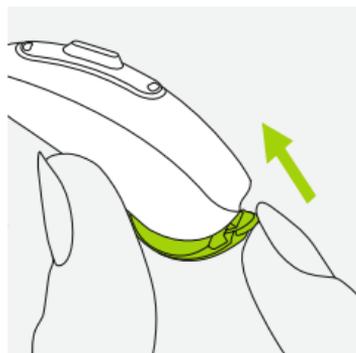

3

Su teléfono muestra una lista de dispositivos compatibles con Bluetooth encontrados. Seleccione el audífono de la lista para emparejar simultáneamente ambos audífonos.

- ① Para obtener más información sobre las instrucciones de emparejamiento con tecnología inalámbrica Bluetooth específica para algunos de los fabricantes de teléfonos más conocidos, visite: www.phonak.es/audeob-direct

9.2 Conexión al teléfono

Después de que sus audífonos se hayan emparejado con su teléfono, se conectarán automáticamente cuando se vuelvan a encender.

- ① La conexión se mantendrá mientras el teléfono permanezca encendido y dentro del radio de alcance.
- ① Su audífono puede conectarse a dos teléfonos al mismo tiempo, pero solo se puede realizar una llamada cada vez.

9.3 Realización de una llamada

Introduzca el número de teléfono con el teclado del teléfono y pulse el botón de marcación. Escuchará el tono de marcación a través de su audífono. Si su teléfono admite llamadas con manos libres (HFP Bluetooth), su audífono recogerá su voz a través de sus propios micrófonos.

9.4 Aceptación de una llamada


Al recibir una llamada, escuchará una notificación de llamada en los audífonos.

La llamada puede aceptarse con una pulsación corta en el botón pulsador del audífono (menos de dos segundos) o en su teléfono como hace normalmente.




9.5 Finalización de una llamada

Puede finalizarse una llamada manteniendo pulsado el botón pulsador del audífono durante más de dos segundos o con su teléfono como hace normalmente.

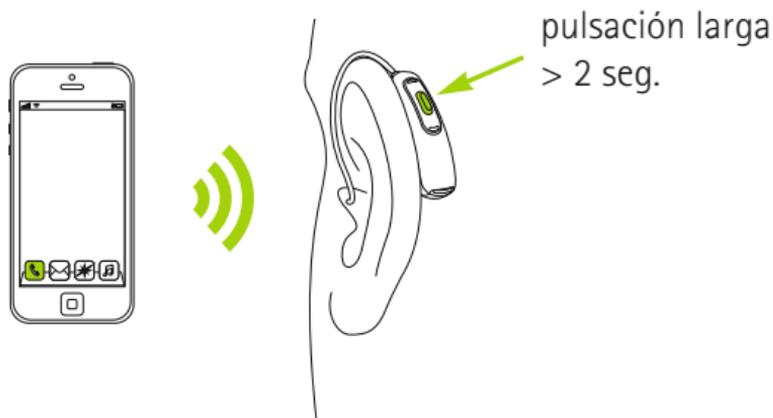

9.6 Rechazo de una llamada

Puede rechazar una llamada entrante manteniendo pulsado el botón pulsador del audífono durante más de dos segundos o con su teléfono como hace normalmente.

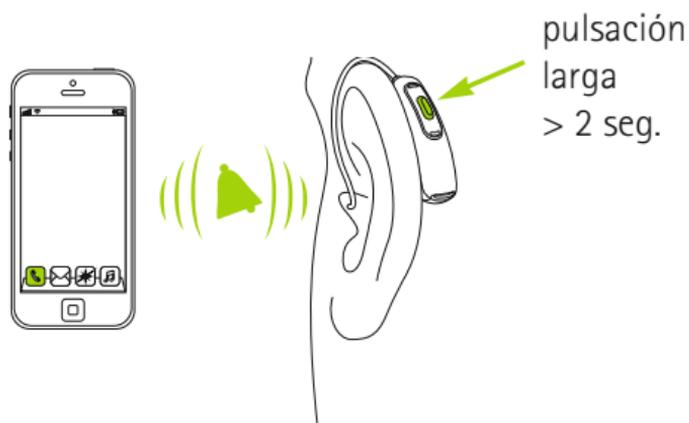

10. Modo avión

Sus audífonos funcionan en un rango de frecuencia de 2,4 GHz a 2,48 GHz. Al realizar un vuelo, algunos operadores indican que todos los dispositivos deben ponerse en modo avión. La activación del modo avión no desactivará la funcionalidad normal del audífono, solo las funciones de conectividad Bluetooth.

10.1 Activar el modo avión



Para desactivar la función inalámbrica y poner el modo avión:

1

Abra la tapa del portapilas.

2

Mantenga pulsado el botón pulsador del audífono durante 10 segundos a la vez que cierra la tapa del portapilas.




En el modo avión, su audífono no podrá conectarse directamente con su teléfono.

10.2 Desactivar el modo avión

Para activar la función inalámbrica y salir del modo avión de nuevo:


1

Abra la tapa del portapilas.



2

Cierre la tapa del portapilas del audífono otra vez.



11. Cuidado y mantenimiento

El cuidado constante y minucioso del audífono es importante para un perfecto rendimiento y una larga duración.

Utilice las siguientes especificaciones como guía. Si desea obtener más información sobre la seguridad del producto, consulte el capítulo 18.2.

Información general

Se recomienda quitarse el audífono antes de utilizar laca o cosméticos, ya que estos productos pueden dañarlo.

Cuando no utilice su audífono, deje abierto el portapilas para que la humedad se pueda evaporar. Asegúrese siempre de secar completamente el audífono tras su utilización. Guárdelo en un lugar seguro, limpio y seco.

Los audífonos son resistentes al agua, al sudor y a la suciedad en las siguientes condiciones:

- La tapa del portapilas está completamente cerrada. Asegúrese que no haya objetos extraños, como cabellos, atrapados en la tapa del portapilas una vez cerrada.
- Tras su exposición al agua, al sudor o a la suciedad, se debe limpiar y secar el audífono.
- El uso y el mantenimiento del audífono se efectúan de acuerdo con las instrucciones de uso del presente documento.

❗ El uso del audífono cerca del agua puede restringir el flujo de aire a la pila, lo que puede impedir su funcionamiento. En el caso de que su dispositivo deje de funcionar tras entrar en contacto con el agua, consulte los pasos para la solución de problemas en el capítulo 17.

Diariamente

Examine el auricular en busca de cerumen y depósitos de humedad. Limpie las superficies con un paño sin pelusas o utilice el cepillo pequeño que se incluye en el estuche del audífono. No utilice nunca productos de limpieza de uso doméstico como detergente, jabón, etc. para limpiar el audífono. No es conveniente enjuagarlo con agua. Si necesita realizar una limpieza intensa del audífono, pida a su audioprotesista consejo e información acerca de filtros o cápsulas deshumidificadoras.

Semanalmente

Limpie el auricular con un paño suave y húmedo o con un paño de limpieza especial para audífonos. Si desea obtener instrucciones de mantenimiento más exhaustivas o para algo más que una limpieza básica, consulte a su audioprotesista.

12. Sustitución del sistema anticerumen


Su audífono está equipado con sistema anticerumen para proteger el altavoz de los daños causados por el cerumen.

Compruebe el sistema anticerumen con frecuencia y sustitúyalo si está sucio o si se reduce el volumen o la calidad sonora del audífono. El sistema anticerumen debe sustituirse periódicamente en el plazo de cuatro a ocho semanas.

12.1 Extracción del auricular del altavoz


1

Extraiga el auricular del altavoz, para ello sujete el altavoz con una mano y el auricular con la otra.

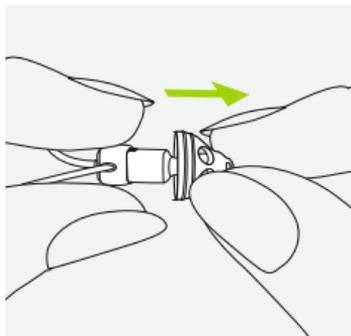


2

Tire suavemente del auricular para extraerlo.

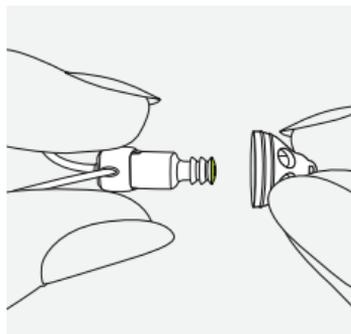

3


Limpie el altavoz con un paño sin pelusas.

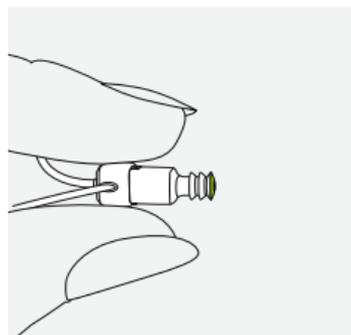

12.2 Sustitución del sistema anticerumen


1

Inserte el lado de extracción de la herramienta de sustitución en el sistema anticerumen usado. El eje del mango debe tocar el borde del sistema anticerumen.

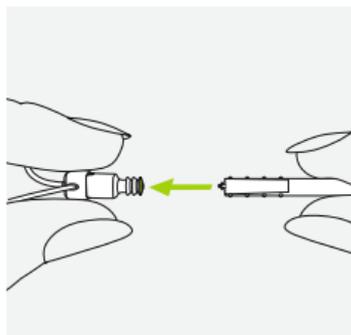


2

Tire cuidadosamente del sistema anticerumen para extraerlo directamente del altavoz. No gire el sistema anticerumen mientras lo extrae.

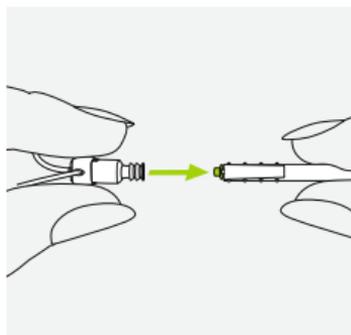


3

Para introducir el sistema anticerumen nuevo, presione con cuidado el lado de introducción de la herramienta de sustitución directamente en el orificio del altavoz hasta que el anillo exterior quede perfectamente alineado.

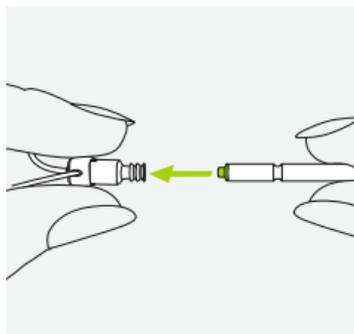

4


Tire de la herramienta directamente hacia afuera. El sistema anticerumen nuevo quedará en su sitio. A continuación, coloque el auricular en el altavoz.

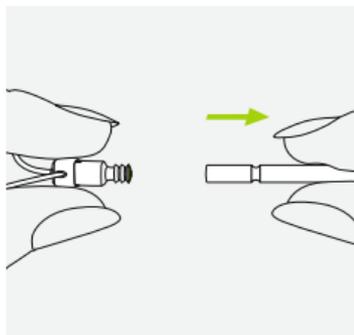

12.3 Colocación del auricular en el altavoz


1

Sujete el altavoz con una mano y el auricular con la otra.

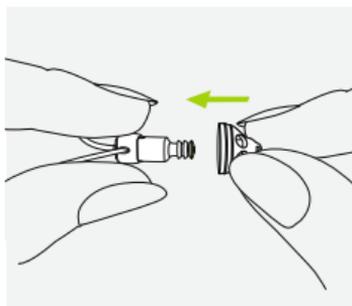


2

Deslice el auricular sobre la salida de sonido del altavoz.

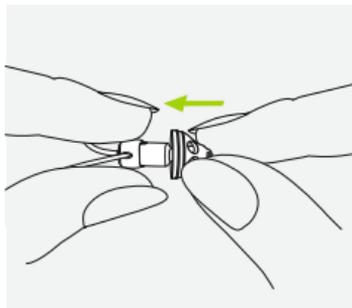


3

El altavoz y el auricular deben encajar perfectamente.

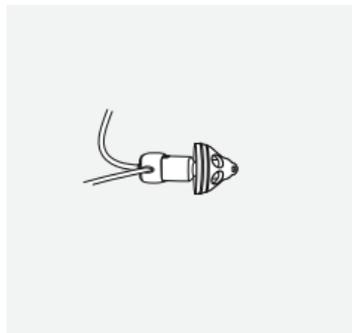

13. Descripción general de la conectividad

La siguiente ilustración muestra las opciones de conectividad disponibles para su audífono.

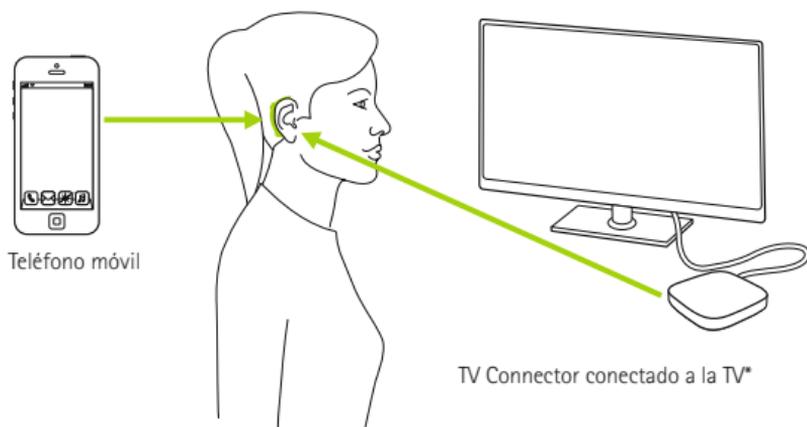

* El TV Connector se puede conectar a cualquier fuente de sonido, tal como un televisor, un ordenador o un sistema de alta fidelidad.

Nota: Su audífono no ofrece conectividad con Roger u otros accesorios inalámbricos de Phonak.

14. Servicio y garantía

Garantía local

Consulte los términos de la garantía local con su audioprotesista o en el establecimiento donde adquirió el audífono.

Garantía internacional

Sonova AG concede una garantía internacional de un año válida a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y de material del audífono, pero no los de accesorios como pilas, tubos, auriculares o receptores externos. La garantía solo es válida si se muestra el comprobante de compra.

La garantía internacional no afecta a ningún derecho legal que usted pudiera tener bajo las leyes nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

Límite de la garantía

Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso o cuidado incorrecto del producto, la exposición a productos químicos o la utilización en condiciones que fueren indebidamente sus funciones. Los daños causados por terceros o centros de servicio no autorizados anulan la garantía. Esta garantía no cubre los servicios prestados por un audioprotesista en su consulta.

Número de serie
(lado izquierdo):

Audioprotesista autorizado
(sello/firma):

Número de serie
(lado derecho):

Fecha de compra:

15. Información de cumplimiento normativo

Europa:

Declaración de conformidad

Por el presente documento, Sonova AG declara que este producto cumple los requisitos impuestos por la directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE, así como los de la Directiva de equipamiento de radio 2014/53/EU. El texto de la Declaración europea de Conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Phonak, cuya dirección se puede encontrar en la lista en www.phonak.com (localizaciones mundiales de Phonak).

Australia/Nueva Zelanda:



R-NZ

Indica la conformidad de un dispositivo con la Gestión de espectro de radio (RSM) vigente y los acuerdos normativos de Australian Communications and Media Authority (ACMA, Autoridad australiana de comunicaciones y medios) para la venta legal en Nueva Zelanda y Australia.

La etiqueta de cumplimiento R-NZ es para los productos de radio suministrados en el mercado de Nueva Zelanda según el nivel de conformidad A1.

Aviso 3:

Este dispositivo se ha sometido a las pruebas pertinentes para determinar su cumplimiento con los límites de los dispositivos digitales de clase B que se estipulan en el apartado 15 de las normas de la FCC y en la norma ICES-003 de Industry Canada, y las ha superado.

Dichos límites garantizan una protección razonable frente a las interferencias dañinas en un entorno doméstico.

Este dispositivo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no pueda producir interferencias en una instalación determinada. En caso de que este dispositivo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (lo que podrá averiguar al apagar y encender el dispositivo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora o vuelva a orientarla.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al proveedor o a un técnico de radio y televisión cualificado para obtener ayuda.

Aviso 4:

Cumplimiento de la ley japonesa de radio y de la ley japonesa del sector de las telecomunicaciones.

Este dispositivo cumple con la ley japonesa de radio (電波法) y la ley japonesa del sector de las telecomunicaciones (電気通信事業法). Este dispositivo no se debe modificar (si se hace, el número de designación concedido perderá su validez).



R 202-SMF050
T D17-0010 202

Información sobre la radio del audífono inalámbrico

Tipo de antena	Antena de cuadro resonante
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480 GHz
Modulación	GFSK, Pi/4 DPSK
Potencia radiada	<1 mW (EIRP)

Bluetooth®

Rango	~1 m (clase 3)
Bluetooth	Versión 4.2
Perfiles compatibles	HFP (perfil manos libres)

16. Información y explicación de los símbolos



Con el símbolo CE, Sonova AG confirma que este producto, incluidos los accesorios, cumple los requisitos de la directiva 93/42/EEC sobre productos sanitarios y la Directiva de equipamiento de radio 2014/53/EU. Los números tras el símbolo CE corresponden al código de las instituciones certificadas a las que se consultó según las directivas anteriormente mencionadas.



Este símbolo indica que los productos descritos en estas instrucciones de uso se adhieren a los requisitos establecidos para un componente aplicado de tipo B de EN 60601-1. La superficie del audífono está catalogada como componente aplicado de tipo B.



Indica el fabricante del producto médico, tal y como lo define la Directiva Europea UE 93/42/CEE.



Este símbolo indica que es importante para el usuario leer y considerar la información relevante en estas instrucciones de uso.



Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las advertencias relevantes de estas instrucciones de uso.



Información importante para la utilización y la seguridad del producto.



Mantener seco cuando se transporte.



La palabra *Bluetooth*[®] y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Marca japonesa para equipos de radio certificados.

Condiciones de funcionamiento

El producto está diseñado para que funcione sin problemas ni limitaciones si se utiliza como es debido, a menos que se indique lo contrario en estas instrucciones de uso. Los audífonos se clasifican como IP68 (profundidad de 1 metro durante 60 minutos) y están diseñados para usarse en diferentes situaciones cotidianas. Por lo que puede despreocuparse por exponer los audífonos a la lluvia o al sudor. No obstante, no están diseñados para usarse en actividades acuáticas que incluyan agua con cloro, jabón, agua salada u otros líquidos con contenido químico.

SN

Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto sanitario específico.

REF

Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar un producto sanitario.



Temperatura durante el transporte y almacenamiento: de -20° a $+60^{\circ}$ Celsius.



Humedad durante el transporte: hasta un 90% (sin condensación).

Humedad de almacenamiento: del 0% al 70%, si no se utiliza. Consulte las instrucciones del capítulo 18.2 relacionadas con el secado del audífono tras su uso.



Presión atmosférica: de 200 hPa a 1.500 hPa



El símbolo con el contenedor tachado pretende concienciarle de que no debe desechar este audífono como desecha los residuos domésticos normales. Deposite su audífono viejo o utilizado en lugares específicos para los residuos electrónicos o dé el audífono a su audioprotesista para que él lo deseche. La correcta eliminación ayuda a proteger la salud y el medio ambiente.

17. Solución de problemas

Problema

El audífono no funciona

El audífono pita

El audífono tiene un volumen demasiado bajo o el sonido está distorsionado

El audífono emite dos pitidos

El audífono se enciende y se apaga (de forma intermitente)

El teléfono no funciona

Causas

Pila agotada

Altavoz/auricular bloqueado

Pila insertada incorrectamente

Audífono apagado

Audífono insertado incorrectamente

Cerumen en el conducto auditivo

Volumen demasiado alto

Pila baja

Altavoz/auricular bloqueado

Volumen demasiado bajo

Se ha modificado la audición

Indicación de pila baja

Humedad en la pila o en el audífono

El audífono está en modo avión

El audífono no está emparejado con el teléfono

i Si el problema continúa, póngase en contacto con su audioprotesista para obtener ayuda

Consulte www.phonak.es/audeob-direct para obtener más información.

Solución

Cambie la pila (capítulo 1 + 5)

Limpie el auricular/abertura del altavoz

Inserte la pila correctamente (capítulo 1 + 5)

Encienda el audífono cerrando completamente la tapa del portapilas (capítulo 4)

Inserte correctamente el audífono (capítulo 6)

Póngase en contacto con su otorrino/médico de familia o con su audioprotesista

Baje el volumen si el control de volumen está disponible (capítulo 1 + 8)

Cambie la pila (capítulo 1 + 5)

Limpie el auricular/abertura del altavoz

Suba el volumen si el control de volumen está disponible (capítulo 1 + 8)

Póngase en contacto con su audioprotesista

Cambie la pila en los siguientes 30 minutos (capítulo 1 + 5)

Limpie la pila y el audífono con un paño seco

Abra y cierre la tapa del portapilas (capítulo 10.2)

Emparéljelo con el teléfono (capítulo 9.1)

18. Información de seguridad importante

Lea la información de las páginas siguientes antes de utilizar su audífono.

Un audífono no restaura una audición normal y no evita ni mejora deficiencias auditivas debidas al estado de los órganos. El uso poco frecuente de un audífono impide al usuario aprovechar al máximo los beneficios que conlleva. El uso de un audífono es únicamente una parte de la rehabilitación auditiva y podría ser necesaria su complementación con formación auditiva y de lectura de los labios.

18.1 Advertencias

-  Los audífonos están diseñados para amplificar y transmitir el sonido a los oídos y, de esta forma, compensar los problemas auditivos. Solamente las personas a las que están destinados los audífonos pueden utilizarlos (ya que están programados especialmente para cada pérdida auditiva). Ninguna otra persona debe utilizarlos, ya que podrían dañar su audición.
-  No utilice los audífonos en zonas con peligro de explosión (minas o áreas industriales con peligro de explosión, entornos con mucho oxígeno o áreas en las que se manipulen productos anestésicos inflamables).
-  No se permite realizar cambios ni modificaciones en el audífono sin que hayan sido aprobados explícitamente por Sonova AG. Tales cambios podrían dañar su oído o el audífono.
-  Las pilas de los audífonos son tóxicas si se ingieren. Manténgalas fuera del alcance de los niños, de personas con discapacidades intelectuales o de mascotas. En caso de ingesta de las pilas, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

 Sus audífonos funcionan en un rango de frecuencia de 2,4 GHz a 2,48 GHz. Al realizar un vuelo, consulte al operador si necesita que los dispositivos se pongan en modo avión. Consulte el capítulo 10.

 Si siente dolor tras la oreja o dentro de ella, si esta se inflama, o en caso de irritación de la piel y acumulación acelerada de cerumen, póngase en contacto con su médico o audioprotesista.

 En contadas ocasiones, la cápsula puede quedarse en el conducto auditivo al extraer el tubo del oído. En el caso improbable de que

la cápsula se quede en el conducto auditivo, se recomienda encarecidamente que se ponga en contacto con un médico para que efectúe una extracción segura.

 Los programas auditivos en modo de micrófono direccional reducen los ruidos del ambiente. Tenga en cuenta que las señales o ruidos de advertencia provenientes de detrás, como por ejemplo, coches, se suprimen parcial o totalmente.

 Este audífono no es adecuado para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas

que pueden provocar asfixia en los niños si las ingieren. Manténgalas fuera del alcance de los niños, de personas con discapacidades intelectuales o de mascotas. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico o centro hospitalario.

 No realice una conexión de cables desde su audífono hasta fuentes de audio externas, como la radio, etc., ya que esto podría ocasionar lesiones corporales (descarga eléctrica).

 Lo siguiente solo se aplica a personas con dispositivos médicos implantables activos (es decir, marcapasos, desfibriladores, etc.):

- Mantenga el audífono inalámbrico a una distancia de al menos 15 cm del implante activo. Si detecta cualquier interferencia, no use los audífonos inalámbricos y póngase en contacto con el fabricante del implante activo. Tenga en cuenta que los cables eléctricos, las descargas electrostáticas, los detectores de metales de los aeropuertos, etc. también pueden causar interferencias.
- Mantenga los imanes (es decir, la herramienta de manipulación de la pila, el imán EasyPhone, etc.) a una distancia de al menos 15 cm del implante activo.

- Si utiliza un TV Connector, consulte el capítulo "Información de seguridad importante" de las instrucciones de uso.



Los audífonos no deben contener cápsulas ni sistemas anticerumen cuando los usen usuarios con tímpanos perforados, conductos auditivos inflamados o cavidades del oído medio expuestas a cualquier otra situación adversa. En estos casos, recomendamos el uso de un auricular personalizado. En el caso improbable de que cualquier pieza de este

producto se quede en el conducto auditivo, se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con un especialista médico para que efectúe una extracción segura.

18.2 Información acerca de la seguridad del producto

- ① Los audífonos de Phonak son resistentes al agua pero no sumergibles. Han sido diseñados para que resistan las actividades normales y la exposición accidental ocasional a condiciones extremas. No sumerja nunca el audífono en agua. Los audífonos Phonak no están diseñados específicamente para soportar largos periodos de inmersión bajo el agua de manera habitual, tal y como sucede en actividades como la natación o el baño. Qútese siempre el audífono antes de dichas actividades, puesto que contiene piezas electrónicas delicadas.
- ① No lave nunca las entradas en el micrófono. Podría perder sus características acústicas especiales.
- ① Proteja su audífono del calor (no lo deje nunca en el coche ni cerca de una ventana). No utilice nunca un microondas ni otros dispositivos emisores de calor para secar el audífono. Pregunte a su audioprotesista acerca de los métodos de secado más adecuados.

- ① La cápsula debe cambiarse cada tres meses o cuando se vuelva rígida o quebradiza. Esto es para prevenir que la cápsula se desprenda del pico del tubo durante la inserción o retirada de la oreja.
- ① Cuando no esté utilizando el audífono, deje abierto el portapilas para que la humedad se pueda evaporar. Asegúrese siempre de secar completamente el audífono tras su utilización. Guárdelo en un lugar seguro, limpio y seco.
- ① Tenga cuidado de no dejarlo caer. Una caída sobre una superficie dura podría dañar el audífono.
- ① Utilice siempre pilas nuevas para el audífono. Si la pila presenta pérdida de fluido, reemplácela inmediatamente por una nueva para evitar irritaciones en la piel. Puede devolver las pilas usadas a su audioprotesista.
- ① Las pilas utilizadas en estos audífonos no deben superar los 1,5 V. No utilice pilas recargables de zinc-plata o ion litio, ya que pueden causar daños graves a los audífonos.

La tabla del capítulo 5 explica exactamente el tipo concreto de pila que necesitan sus audífonos.

① Retire la pila si no va a utilizar el audífono durante un periodo de tiempo largo.

① Los exámenes dentales o médicos especiales en los que se utiliza radiación, descritos a continuación, pueden afectar de manera negativa al correcto funcionamiento de los audífonos. Retírelos o manténgalos fuera de la sala/zona de reconocimiento antes de someterse a los procedimientos siguientes:

- Examen médico o dental con rayos X (también tomografía axial computarizada).

- Exámenes médicos con resonancias magnéticas/ resonancias magnéticas nucleares, en los que se generan campos magnéticos.

No es necesario retirar los audífonos al atravesar puertas de seguridad (aeropuertos, etc.). En el caso de que se usen rayos X, se hará en dosis muy bajas y no afectará a los audífonos.

① No utilice el audífono en lugares en los que esté prohibido el uso de equipos electrónicos.

Su audioprotesista:



029-0530-06N2.00/2017-06/nlg © Sonova AG All rights reserved



Fabricante:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Suiza

www.phonak.es



sonova
HEAR THE WORLD

